

OMKA
OMKA-OMEGA ÖLÇME KONTROL SİSTEMLERİ
LABORATUVAR CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TEST SERTİFİKASI



Talep Eden/Requirer	:AGER END. METAL ÜRÜN. SAN ve TİC. LTD.ŞTİ.
Talep Tarihi/Request date	:31 / 10 / 2019
Numune Girişi/Sample inlet	:01 / 11 / 2019
Rapor Tarihi/Date of the Report	:10 / 12 / 2019
Talebin Tanımı/Description of request	:NSS – CASS TUZ TESTİ
Numune Tanımı/Kind of material	:210x290 mm DÜZ BOYALI PANEL
Numune Gönderiliş Şekli/Incoming type of the material	:ELDEN TESLİM
Test/Analiz Standardı/Required Test	:DIN EN ISO 9227 : 2012
Rapor No	:101219.GK.01
Toplam Numune Sayısı/Total number of sample	:1

Etiket

Testi Yapan
Gürcan KAPTANOĞLU

Testi Onaylayan
Dr. Serap KÖKTAŞ KOCA

NAC-009-TL
101219.GK.01
10/12/2019



Powered by Scansler.com



Powered by Scansler.com



TEST SERTİFİKASI

DIN EN ISO 9227:2012

NUMUNEYE AİT BİLGİLER

Tanımı	DÜZ BOYALI PANEL
Yüzey işlem tanımı	-
Kaplama kalınlığı (µm)	78
Ölçüleri (mm)	210 x 290
Test öncesi uygulanan işlem	-

TEST ŞARTLARI

İklimlendirme türü	NSS	CASS
Test süresi [saat]	912	
Sıcaklık [°C]	35 ± 2	50 °C ± 2
Ölçüm Belirsizliği [°C]	± 1,04	± 1,04
Ara kontrol [saat]	24	

Numuneler test kabineine dikey pozisyondan 20 ± 5° açıyla yerleştirilmiştir.

Test Ortam ve Numune Kondisyonlama Şartları: Sıcaklık 23°C±2°C Bağıl Nem 50%±5% Süre 16 Saat

Numuneye test sonunda uygulanan işlemler: Numune 1 saat kurumaya bırakılmıştır. Musluk suyu ile yıkanıp, hava akımında Kurutulmuştur.

TEST SONUÇLARI

Parametre	Standart	Sonuç	Açıklama
Kabarcıklanma	DIN EN ISO 4628-2	VAR	-
Pas Derecesi	DIN EN ISO 4628-3	N/A	-
Boya Ayrılması (mm)	DIN EN ISO 4628-8	c = 5,107	Ölçüm Belirsizliği: ±15,8 µm
Korozyon Derecesi (mm)	DIN EN ISO 4628-8	d = 3,473	Ölçüm Belirsizliği: ±15,8 µm

İklimlendirme türü:

NSS Nötr tuz spreyi testi

CASS Bakır ile hızlandırılmış asetik asitli - tuz spreyi testi

Deney Metodundan Sapmalar

Açıklama Ara kontrol ve test sonunda yüzeyde blister görülmüş olup, beyaz paslanma görülmüştür.

Açıklamalar:

Bu test raporundaki sonuçlar sadece testi yapılan numuneye ait olup OMKA – OMEGA Test Laboratuvarının yazılı izni Olmadan değişiklik yapılamaz ve kısmen çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.


Raporlanan belirsizlik genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlikten kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenirlilik düzeyi % 95 tir.



TEST SERTİFİKASI

EKLER :

TEST ÖNCESİ

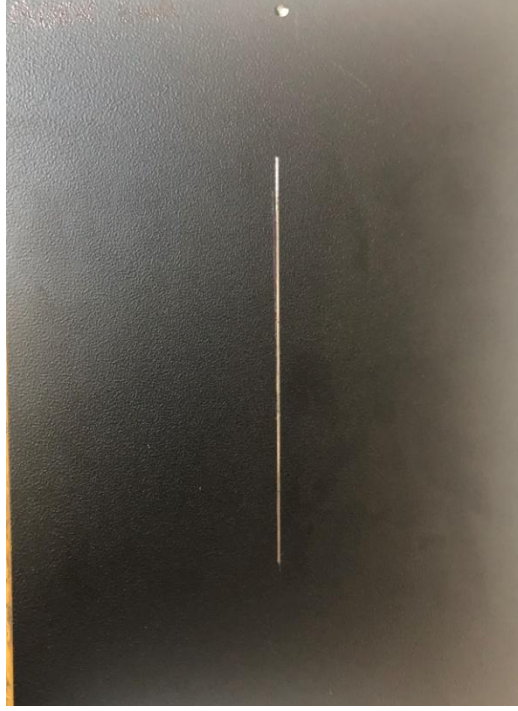

TEST SONRASI

